


计量授权证书附件

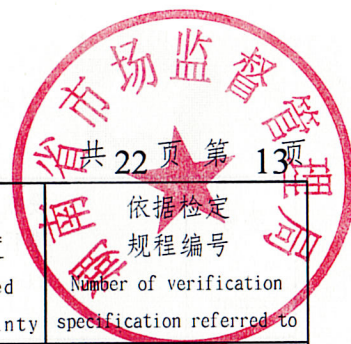

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
92	工作用玻璃液体温度计	(0~300) °C	MPE: ± (0.2~7.5) °C	JJG130-2011
93	血压计(表)	(0~40) kPa	MPE: ±0.5kPa	JJG 270-2008
94	回弹仪	钢钻率定值: (70~90) 指针摩擦力: (0.1~1)N 弹击杆端部球面半径: (17~46) mm 弹簧刚度: (60~1200) N/m 弹击拉簧拉伸长度: (0~150) mm	钢钻率定值: ±2 指针摩擦力: (H980/H550/H450/M225 : ±0.15N, L75/L20: ± 0.10N) 弹击杆端部球面半径: ± 1.0mm; 弹击拉簧刚度: (H980/H550/H450/M225 /L75/L20, 分别为: ± (45/50/40/30/12/4)N/m); 弹击拉簧拉伸长度: (H980/H550/H450: ± 0.5mm, M225/L75/L20: ±0.3mm)	JJG817-2011
95	液相色谱仪	紫外—可见光检测器、 二极管阵列检测器、荧 光检测器、示差折光率 检测器	定性重复性: ≤1.0% 定量重复性: ≤3.0%	JJG 705-2014
96	砝码	(0.1~25) kg	M1 等级及以下	JJG99-2006

计量授权证书附件

共22页 第14页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
97	温湿度计 (表)	温度: 5℃~50℃ 湿度: 30%RH~95%RH	温度 MPE: ±2℃, 湿度 MPE: ±5%RH (40%RH~70%RH, 20℃); 湿度 MPE: ±7%RH (40%RH 以下或 70%RH 以 上, 20℃);	JJG 205-2005
98	大气采样器	(100~6000) mL/min	MPE: ±5%	JJG 956-2013
99	原子吸收分光光度计	(190~900) nm 火焰原子化器 石墨炉原子化器	MPE: ±0.5nm Cu 检出限: 0.02ug/mL Cd 检出限: 0.4pg	JJG 694-2009
100	三相电能表	U: 3× (0-400) V; I: 3× (0-120) A	0.2 级及以下	JJG596-2012 JJG307-2006
101	水平仪示值检定器	(1~1.5) mm/m	MPE: 标尺分度值的 6%	JJG 191-2018
102	一般压力表 (电接点压力表除外)	(-0.1~60) MPa	1.6 级及以下	JJG52-2013
103	扭矩扳子	(5~1000) Nm	1 级及以下	JJG707-2014
104	氨气检测仪	(0~100) × 10 ⁻⁶ mol/mol	0 ≤ c ≤ 50 × 10 ⁻⁶ mol/mol MPE : ±10% 50 × 10 ⁻⁶ mol/mol < c ≤ 100 × 10 ⁻⁶ mol/mol MPE: ±6% (分析仪), ± 10% (报警器)	JJG1105-2015

国家市场监督管理总局印制